□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ HB8 □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□	HB8 □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□
□□□ □□□□	□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□	spunbond + meltblown + spunbond □SMS□
□□□□	□□□□
□□□□ □□□□□	□□□□□□ □□□□
□□□□□□□	HB8 # □□□□
□□□□□□□	80 * 180 □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □ □□□□ □□□ □□
□□□□□□ □□ □□□□	□□□□□□□ □□□□□□ □□ □ 100 □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ · □ nontextile □ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□	□ □□□□□ □□□□□□ □□ □ □□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ HB8 □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

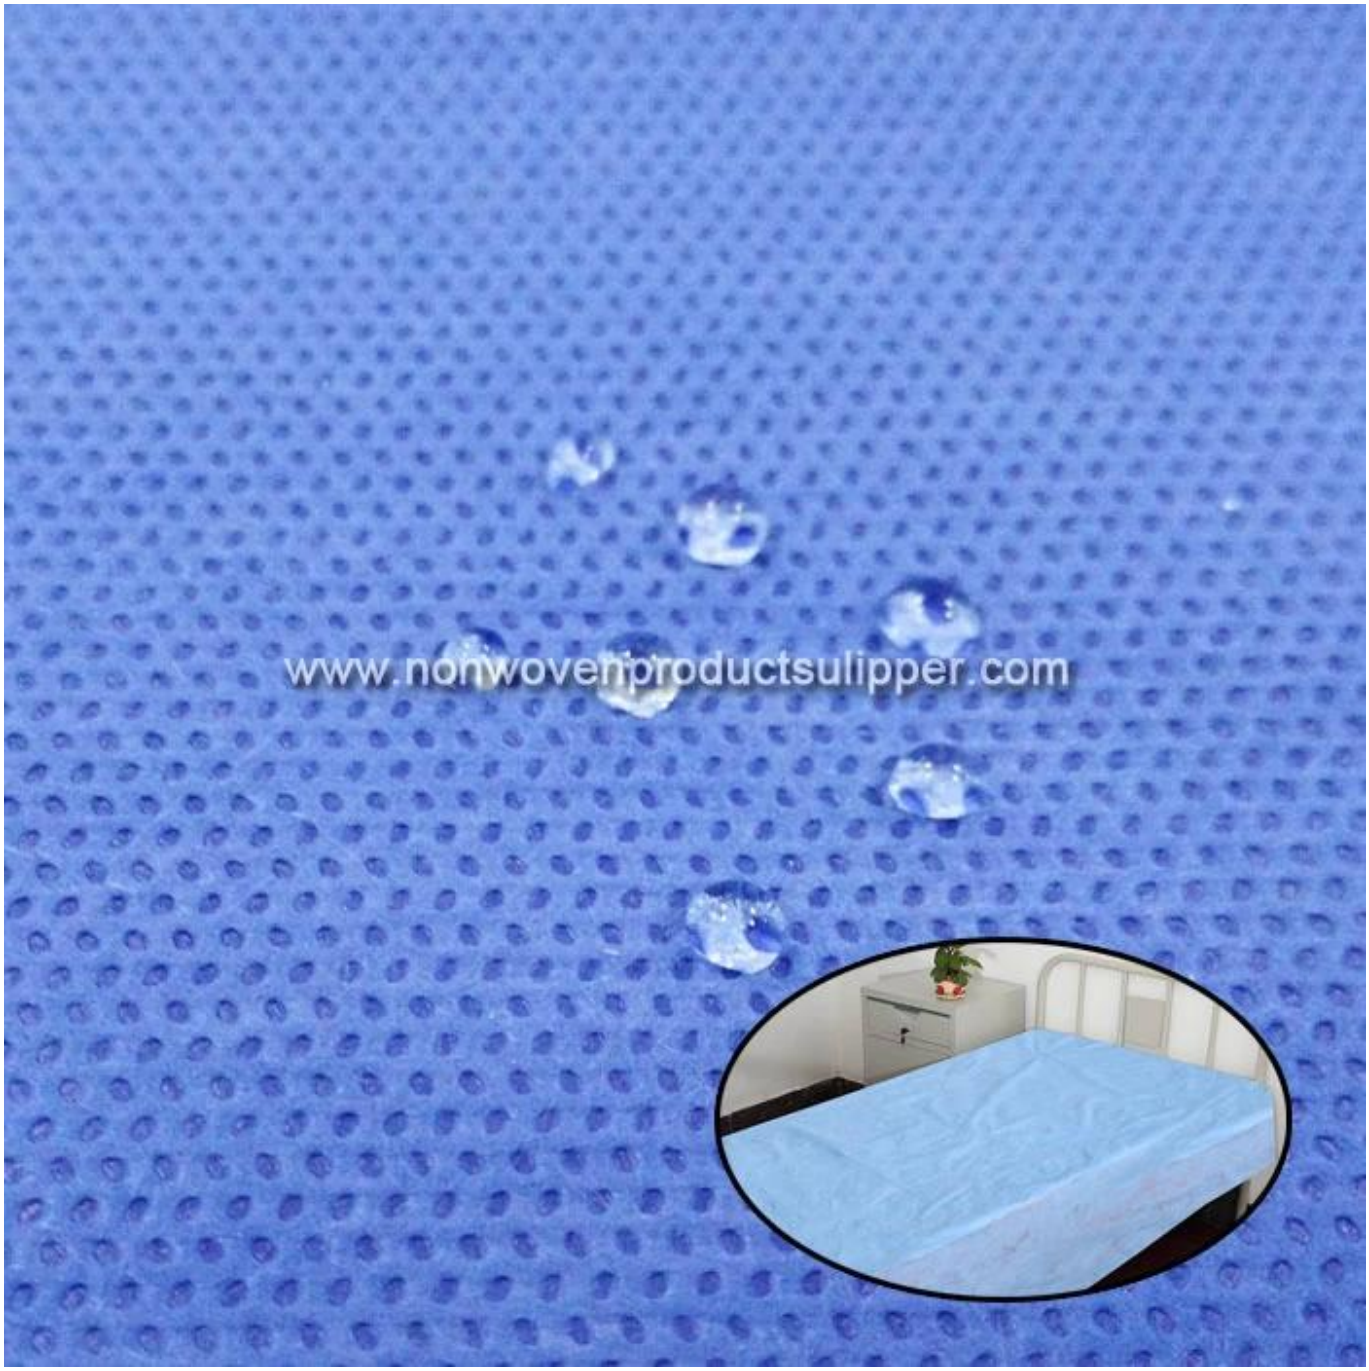
www.nonwovenproductsulipper.com

www.nonwovenproductsulipper.com

للحصول على ورقة السرير المريض HB8 المنتج التعبئة والتغليف والشحن من المعدات الطبية

القابل للتصرف للحصول على ورقة السرير المريض HB8 التعليمات من المعدات الطبية

□□□□	□□□□□
q1: □□□□□□□ □□ □□□□ □□	A1: □□□□□ □ □□□.
q2: □□□□ □□ □□	a2: □□□□ 50000 :□□□□□
q3: □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□	a3: □□□□□ .□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ .□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□.
Q4: □□□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□	A4: □□□□□□ □□□□□□□ □□ □ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□
Q5: □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□	a5: □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ .□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□.□

q6: [illegible]	a6: [illegible] 4-2 [illegible]
[illegible] :7 [illegible]	a7: [illegible] OEM. [illegible]
[illegible] :8 [illegible]	a8: [illegible] 24 [illegible]