產品說明 EN14683 II型熔噴過濾器

項目 熔噴過濾器
組成 聚丙烯
平均佈重 25 GSM 40 GSM
顏色 白色，黑色

功能

柔軟，阻燃，防水，透氣，靜電，無污染，無毒，環保，具有較高的過濾性能和柔軟手感，可以阻擋和過濾灰塵，顆粒，細菌和病毒；

標準：EN14683 I型/ II型/ IIR型，ASTM F2100 1級/ 2級/ 3級，FFP1 / FFP2，KN95，KN99，KF94，N95，N100

寬度 17.5 / 26厘米 25/26厘米
過濾係數 BFE99％ BFE 99.5％〜100％

空氣流動 在32L / min的空氣流量下PFE鹽（NaCl）

局部98％

在85L / min的空氣流量下PFE鹽（NaCl）
局部95％

在85 L / min的空氣流量下PFE鹽
（NaCl）局部99％

在95L / min的空氣流量下：PFE鹽（NaCl）和油基
（DEHS）均95％
長度 1000/2500 m 1300米
每卷直徑 43/73厘米 55厘米
包 3/2卷/箱 2卷/箱
重量 約15-16公斤/ 14-15公斤/ 32-35公斤 約26-28公斤/ 27-29公斤
紙箱尺寸 49.5x49.5x54.5 / 73 * 73 * 52.5厘米 49.5x49.5x54.5厘米

模型 類型 重量g /m³ 最大電阻（Pa） 最大滲透率（％） 物產 流量L / min 中 羽毛

P系列

FFP1 40 <40 > 80

石油和非石油顆粒

95升 DOP FFP1面罩
FFP2 / KF94 50 <160 > 94 95升 DOP FFP2 / KF94口罩
FFP3 80 <190 > 97 95升 DOP FFP3面膜

KN系列

KN90 40 <80 > 90

非油性顆粒 85升

氯化鈉 KN90
KN95 / N95 50 <100 > 95 氯化鈉 KN95，N95
KN100 80 <175 > 99.97 氯化鈉 KN99，N100

產品展示 EN14683 II型熔噴過濾器

PP□□□□□□□□

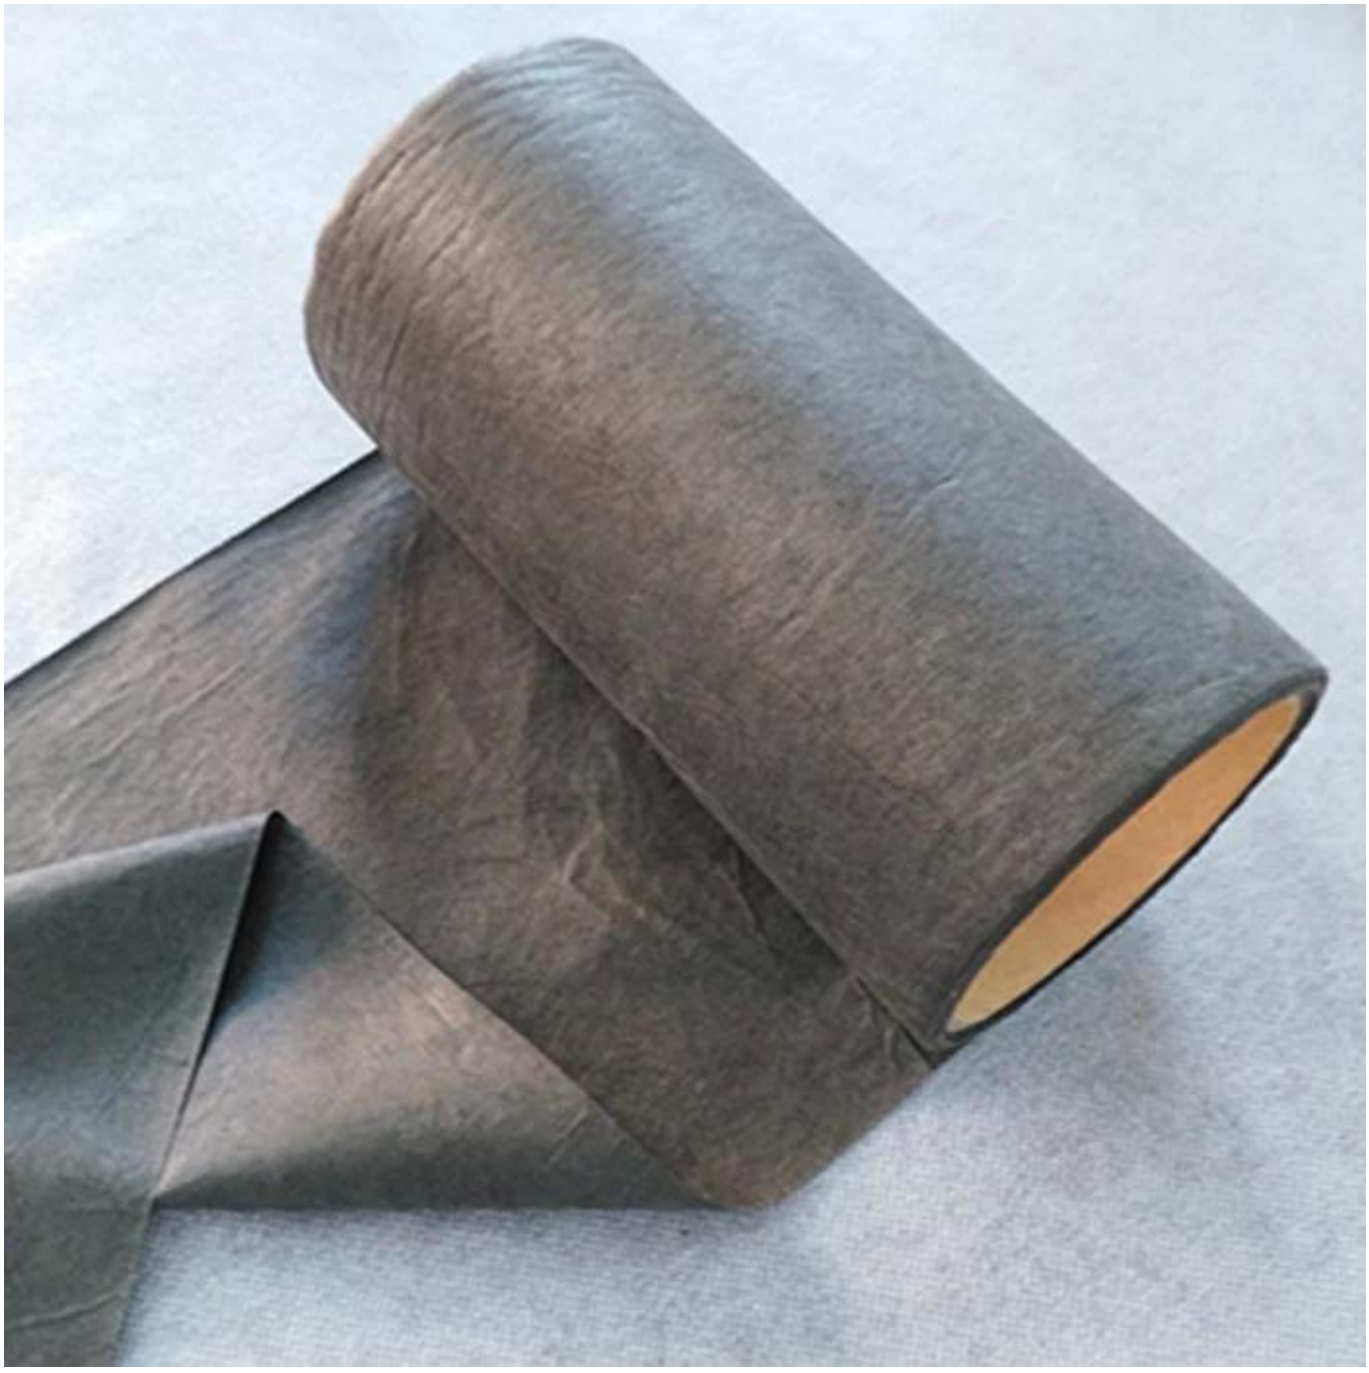

熔噴聚丙烯銷售

EN14683 II型熔噴過濾器的產品包裝和運輸

我們公司
佛山市GUIDE紡織品有限公司，位於佛山市。我們正在從事
從2005年開始製造和銷售非織造布及非織造布相關產品。到現在，
我們擁有專業的精英銷售團隊，多條寬度為
1.6M，1.9M，2.1M，2.4M，2.5M，3.2M，3.7M，4.8M等。我們的產品在國內均暢銷
和海外市場，廣泛用於農業和園藝，醫療和衛生，
個人護理和美容，行業應用，包裝和包裝，基礎和建築，
酒店，飯店，勞動保護及家庭，裝潢等。
（聚丙烯）無紡布，寵物（聚酯）無紡布，sms無紡布，彈性

□□□

检 测 报 告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website)：www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code)：7815080747
报告编号(Report No)：ZFLJ2642756	Page 1 of 3

Applicant Information (客户信息)

Applicant Name(委托单位) : FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD(佛山凯缎纺织品有限公司)
Applicant Address(委托单位地址) :Yonghao Industrial Park, Yongqing RD., Yanbu, Dali Town, Nanhai Dist., Foshan, G.D.528247, CHINA(佛山市南海区大沥镇盐步永青路永好产业园)

Sample Information (样品信息)

Sample Description(样品描述) : meltblown non woven fabric 25gsm(熔喷无纺布 25 克)
Style No.(款号) : SSKX-25
Specification(规格) : 260mm
Sample Quantity(样品数量) : 1roll (1 卷)
Colour(颜色) : white(白色)
Model(型号) : SSKX

- Sample Receiving date (收到样品的日期) : 2020-08-15
- Report date (报告日期) : 2020-08-21
- The original sample is sticked on the last paper. (送检样品原样粘贴在本报告的末页)

Test Performed (检验标准)

Judgement according to(评定依据):
ASTM F2100-2019e1 Standard Specification for Performance of Materials Used in Medical Face Masks Level 2
医用口罩用材料性能的技术规范 2 级
- Selected test(s) as requested by applicants. (本实验室根据客户要求完成以下检测内容)

Pronounce (声明)

The results shown in this report refer only to sample(s) tested unless otherwise stated.All the items are performed in the standard conditions, except the noted cases.(除非特别说明，测试结果只对来样负责。所有测试项目均在标准规定的环境下进行，有注明除外。)
Except for the requirement of the client, the test results and the conformity judgement of this report do not take the uncertainty of the test results into account.(除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。)

Signed for and on behalf of
CNTAC Testing Service Co.,Ltd.(Foshan)
Approved by
(批准)

张志荣 (Except for microbiological project 微生物项目除外)

罗桂娟 (Microbiological project 微生物项目)

检 测 报 告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website)：www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code)：7815080747
报告编号(Report No)：ZFLJ2642756	Page 2 of 3

--- Test Result (测试结果) ---

	Test Result(测试结果)	Requirements(评定条件)	Judgement(判定)

1. Sub-Micron Particulate Filtration Efficiency (PFE) at 0.1 micron (0.1 微米的颗粒过滤效率)

ASTM F2299/F2299M-03(R 2017)

Aerosol: PSL, Test area: 100cm^2, Airflow: 32L/min, Sampling time: 1min, Thickness: 2.3μm, Basis Weight: 25.0g/m^2（气溶胶类型：PSL，测试面积：100cm^2，测试流量：32L/min，采样时间：1min，厚度：2.3μm，单位面积质量: 25.0g/m^2）

Unit(单位): <%>

sample 1#(样品 1)	98.8	≥ 98	Pass(合格)
sample 2#(样品 2)	99.0		
sample 3#(样品 3)	98.6		
sample 4#(样品 4)	98.1		
sample 5#(样品 5)	98.1		
Minimum(最小值)	98.1		

2. Bacterial Filtration Efficiency(细菌过滤效率) *ASTM F 2101-19*

Flow rate: 28.3L/min, Test area: 77cm2, Test bacteria culture: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Particle Diameter: 3.0μm, Inside of the test mask was facing towards the challenge aerosol, The average plate count results of the positive controls: 2.6×103CFU, The average plate count results of the negative controls: <1CFU(气体流速：28.3L/min，测试面积：77cm2,试验菌种：金黄色葡萄球菌 ATCC 6538，平均颗粒直径：3.0μm，口罩内侧面朝向气溶胶室，阳性质控值：2.6×103CFU，阴性质控值：<1CFU)

Unit(单位): <%>

sample 1#(样品 1)	99.9	≥ 98	Pass(合格)
sample 2#(样品 2)	99.9		
sample 3#(样品 3)	99.9		
sample 4#(样品 4)	99.9		
sample 5#(样品 5)	99.9		

检 测 报 告(Testing Report)	防伪查询网址(Security website)：www.fcl-sz.org.cn 防伪码(Security code)：7815080747
报告编号(Report No)：ZFLJ2642756	Page 3 of 3

Original (送检样品原样)

======= End of Report (检测报告结束) ======

EN14683 II型熔噴過濾器常見問題解答
題回答
問題1：您有庫存嗎？ A1：是的，我們有。
問題2：您的起訂量是多少？ A2：定制：1噸
Q3：如何獲得樣品？ A3：如果您需要樣品進行測試，我們可以根據您的要求進行製造。但是我們需要收取樣品費。如果這是我們庫存的常規產品，則只需支付運費，
即可免費提供樣品。
問題4：您的包裹詳細信息是什麼？ A4：每件單獨包裝，或根據客戶要求
問題5：如果無法在您的網站上找到想要的東西，該怎麼辦？ A5：請隨時通過電子郵件與我們聯繫，並發送您想要的產品的詳細信息。我們將檢查是否有貨。
問題6：批量生產的交貨時間如何？ A6：老實說，這取決於訂單數量和您下訂單的季節。一般來說，交貨時間約為2-4週。因此，我們建議您儘早開始查詢。
Q7：可以建立客戶自己的品牌名稱嗎？ A7：好的。我們熱忱歡迎OEM客戶。我們可以討論包裝，設計等。
Q8：什麼時候可以拿到價格？ A8：通常我們在收到您的詢問詳細信息後24小時內報價。如果您非常想獲得價格，請致電我們或在您的電子郵件中告訴我們，以便我們盡快
報價您的價格。